

# 96-луночные микротитровальные планшеты в полистироле

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59


Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [bai@nt-rt.ru](mailto:bai@nt-rt.ru) || сайт: <https://biosigma.nt-rt.ru>

## BSD001

PIASTRA PER MICROMETODI 96 POZZETTI FONDO "U"  
IN CONFEZIONE SINGOLA IN SCATOLA DA 50PZ.

*MICROTITER PLATE 96 WELL "U" BOTTOM INDIVIDUALLY WRAPPED IN BOX OF 50 PCS.*

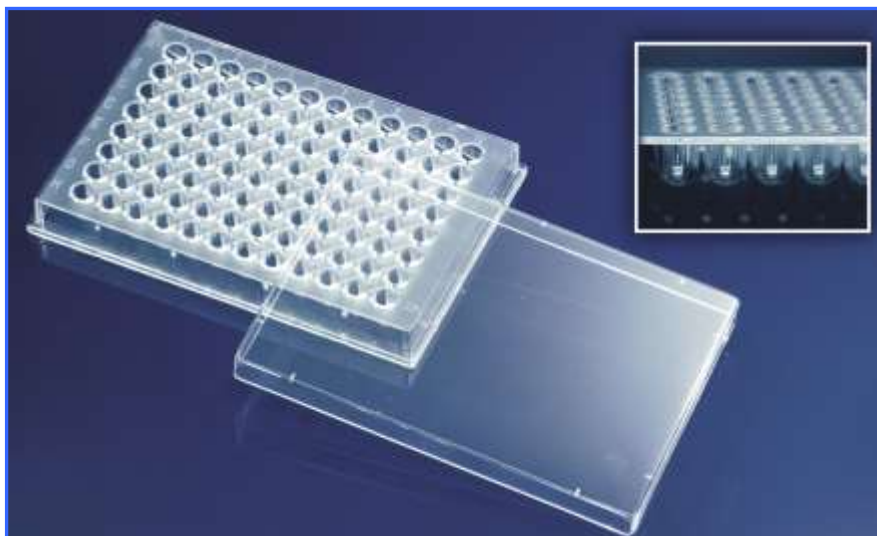

### CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DEL PRODOTTO/FEATURES AND PRODUCT DIMENSIONS

|                                                     |                     |                                              |                                  |
|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Fabbricante                                         | Anicrin Srl - Italy | Manufacturer                                 |                                  |
| Codice Fabbricante                                  | M09600U0            | Manufacturer code                            |                                  |
| Stato microbiologico/ <i>Microbiological status</i> | <b>NON STERILE</b>  | Materiale impiegato/ <i>Material used</i>    | POLISTIROLO / <i>POLYSTYRENE</i> |
| Lunghezza piastra/ <i>Length plate</i> (mm)         | 85,80               | Peso/ <i>Weight</i> (g)                      | 40,00 ±1                         |
| Larghezza piastra/ <i>Plate width</i> (mm)          | 127,70              | Capacità pozzetto/ <i>Well capacity</i> (ml) | 0,281                            |
| Altezza piastra/ <i>Plate height</i> (mm)           | 14,10               | N° pozzetti/ <i>N. of Well</i>               | 96                               |

DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO

DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AD USO PROFESSIONALE

*IN VITRO DIAGNOSTIC MEDICAL DEVICE*

*FOR PROFESSIONAL USE ONLY*

Codice CND: W0503010204 PIASTRE IN MATERIALE PLASTICO PER ANALISI CON MICROMETODICHE

**RACCOMANDAZIONI D'USO/ RECOMMENDATIONS FOR USE** (a carattere esclusivamente informativo/ *as informative*) :


- Utilizzare esclusivamente per analisi di laboratorio/ *Use only for laboratory analysis,*
- In caso di fuoriuscita del contenuto usare i guanti pericolo di contaminazione / *Use gloves: contamination risk if contents leaks,*
- Non utilizzare il prodotto scaduto / *Do not use after expiry date or if packing is opened,*

## REF BSD002

PIASTRA PER MICROMETODI 96 POZZETTI FONDO "V"  
IN CONFEZIONE SINGOLA IN SCATOLA DA 50PZ.

*MICROTITER PLATE 96 WELL "V" BOTTOM  
INDIVIDUALLY WRAPPED IN BOX OF 50 PCS.*

Codice CND: W0503010204 PIASTRE IN MATERIALE PLASTICO PER ANALISI CON MICROMETODICHE

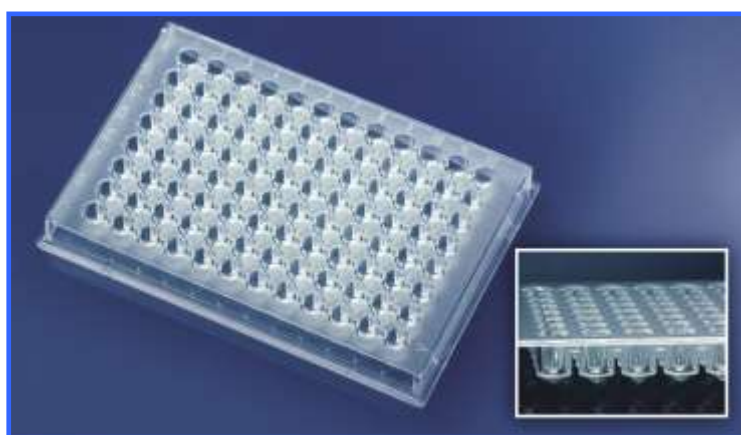

| CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DEL PRODOTTO |                           | FEATURES AND PRODUCT DIMENSIONS |
|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Fabbricante                               | Anicrin Srl - Italy       | Manufacturer                    |
| Codice Fabbricante                        | M09600V0                  | Manufacturer Code               |
| Stato microbiologico                      | NON STERILE / NOT STERILE | Microbiological status          |
| Materiale impiegato                       | POLISTIROLO / POLYSTYRENE | Material used                   |
| Lunghezza piastra (mm)                    | 127,70                    | Length plate (mm)               |
| Larghezza piastra (mm)                    | 85,80                     | Plate width (mm)                |
| Altezza piastra (mm)                      | 14,10                     | Plate height (mm)               |
| Peso (g)                                  | 40,00 ±1                  | Weight (g)                      |
| Capacità pozzetto(ml)                     | 0,219                     | Well capacity (ml)              |
| N° pozzetti                               | 96                        | N. of Well                      |

Dispositivo Medico Diagnostico In Vitro  
Destinato Esclusivamente Ad Uso Professionale  
*In Vitro Diagnostic Medical Device*  
*For Professional Use Only*

**RACCOMANDAZIONI D'USO/ RECOMMENDATIONS FOR USE** (a carattere esclusivamente informativo/ as informative) :


- Utilizzare esclusivamente per analisi di laboratorio/ Use only for laboratory analysis,

## REF BSD003

PIASTRA PER MICROMETODI 96 POZZETTI FONDO PIATTO  
IN CONFEZIONE SINGOLA IN SCATOLA DA 50PZ.

*MICROTITER PLATE 96 WELLS FLAT BOTTOM  
INDIVIDUALLY WRAPPED IN BOX OF 50 PCS.*

Codice CND: W0503010204 PIASTRE IN MATERIALE PLASTICO PER ANALISI CON MICROMETODICHE

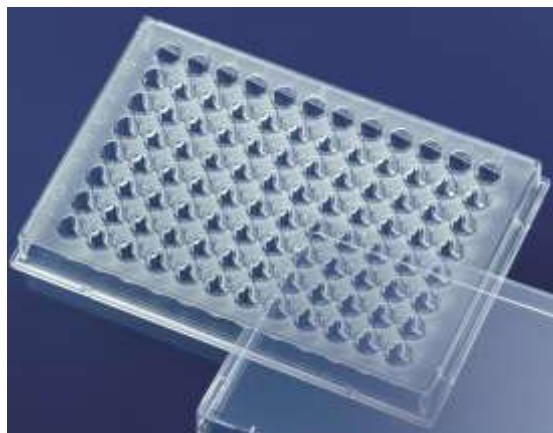

| CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DEL PRODOTTO |                           | FEATURES AND PRODUCT DIMENSIONS |
|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Fabbricante                               | Anicrin Srl - Italy       | Manufacturer                    |
| Codice Fabbricante                        | M09600P0                  | Manufacturer Code               |
| Stato microbiologico                      | NON STERILE / NOT STERILE | Microbiological status          |
| Materiale impiegato                       | POLISTIROLO / POLYSTYRENE | Material used                   |
| Lunghezza piastra (mm)                    | 128,00                    | Length plate (mm)               |
| Larghezza piastra (mm)                    | 85,80                     | Plate width (mm)                |
| Altezza piastra (mm)                      | 14,10                     | Plate height (mm)               |
| Peso (g)                                  | 40,00 ±1                  | Weight (g)                      |
| Capacità pozzetto(ml)                     | 0,404                     | Well capacity (ml)              |
| N° pozzetti                               | 96                        | N. of Well                      |

Dispositivo Medico Diagnostico In Vitro  
Destinato Esclusivamente Ad Uso Professionale  
*In Vitro Diagnostic Medical Device  
For Professional Use Only*


**RACCOMANDAZIONI D'USO/ RECOMMENDATIONS FOR USE** (a carattere esclusivamente informativo/ as informative) :

- Utilizzare esclusivamente per analisi di laboratorio/ *Use only for laboratory analysis,*
- In caso di fuoriuscita del contenuto usare i guanti pericolo di contaminazione / *Use gloves: contamination risk if contents leaks,*

## REF BSD013

**COPERCHIO PIASTRA PER MICROMETODI 96 POZZETTI-  
IN CONFEZIONE SINGOLA IN SCATOLA DA 50PZ.  
COVER FOR MICROTITER PLATE 96 WELLS- INDIVIDUALLY WRAPPED IN BOX OF 50 PCS.**

Codice CND: W0503010204 PIASTRE IN MATERIALE PLASTICO PER ANALISI CON MICROMETODICHE

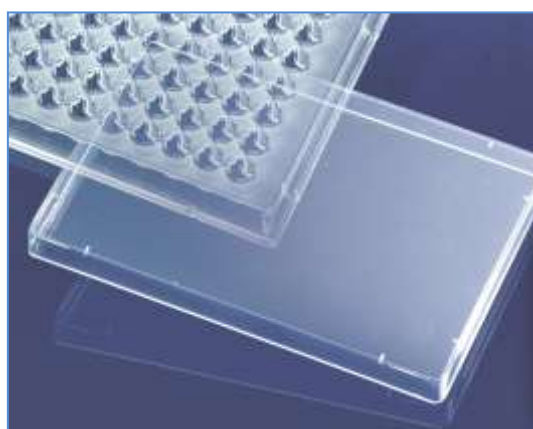

Dispositivo Medico Diagnostico In Vitro Destinato Esclusivamente Ad Uso Professionale  
*In Vitro Diagnostic Medical Device For Professional Use Only*

| CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DEL PRODOTTO |                           | FEATURES AND PRODUCT DIMENSIONS |
|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Fabbricante                               | ANICRIN SRL - ITALY       | Manufacturer                    |
| Codice Fabbricante                        | M09600LO                  | Manufacturer Code               |
| Stato microbiologico                      | NON STERILE / NOT STERILE | Microbiological status          |
| Materiale impiegato                       | POLISTIROLO / POLYSTYRENE | Material used                   |
| Lunghezza piastra (mm)                    | 126,30                    | Length plate (mm)               |
| Larghezza piastra (mm)                    | 84,50                     | Plate width (mm)                |
| Altezza piastra (mm)                      | 10,60                     | Plate height (mm)               |
| Peso (g)                                  | 18,00 ±1                  | Weight (g)                      |
| Capacità pozzetto(ml)                     | 0,219                     | Well capacity (ml)              |
| N° pozzetti                               | 96                        | N. of Well                      |


**RACCOMANDAZIONI D'USO/ RECOMMENDATIONS FOR USE** (a carattere esclusivamente informativo/ as informative) :

- Utilizzare esclusivamente per analisi di laboratorio/ *Use only for laboratory analysis,*
- In caso di fuoriuscita del contenuto usare i guanti pericolo di contaminazione / *Use gloves: contamination risk if contents leaks,*
- Non utilizzare il prodotto scaduto / *Do not use after expiry date or if packing is opened,*
- Non variare la destinazione d'uso/ *Do not vary the intended purpose of the product,*
- Prodotto non adatto ai bambini/ *Keep out of reach of children,*
- Conservare in luogo asciutto/ *Store in dry place and far from the direct light,*
- Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo la normativa vigente/ *Disposal: use appropriate, personal protective equipment and act according to applicable regulations.*

## REF BSD013

**COPERCHIO PIASTRA PER MICROMETODI 96 POZZETTI-  
IN CONFEZIONE SINGOLA IN SCATOLA DA 50PZ.  
COVER FOR MICROTITER PLATE 96 WELLS- INDIVIDUALLY WRAPPED IN BOX OF 50 PCS.**

Codice CND: W0503010204 PIASTRE IN MATERIALE PLASTICO PER ANALISI CON MICROMETODICHE

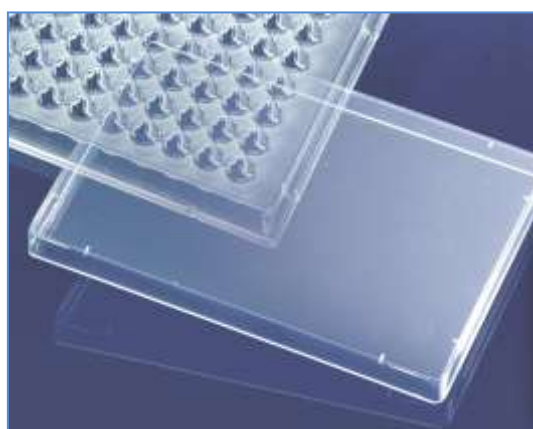

Dispositivo Medico Diagnostico In Vitro Destinato Esclusivamente Ad Uso Professionale  
*In Vitro Diagnostic Medical Device For Professional Use Only*

| CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DEL PRODOTTO |                           | FEATURES AND PRODUCT DIMENSIONS |
|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Fabbricante                               | ANICRIN SRL - ITALY       | Manufacturer                    |
| Codice Fabbricante                        | M09600LO                  | Manufacturer Code               |
| Stato microbiologico                      | NON STERILE / NOT STERILE | Microbiological status          |
| Materiale impiegato                       | POLISTIROLO / POLYSTYRENE | Material used                   |
| Lunghezza piastra (mm)                    | 126,30                    | Length plate (mm)               |
| Larghezza piastra (mm)                    | 84,50                     | Plate width (mm)                |
| Altezza piastra (mm)                      | 10,60                     | Plate height (mm)               |
| Peso (g)                                  | 18,00 ±1                  | Weight (g)                      |
| Capacità pozzetto(ml)                     | 0,219                     | Well capacity (ml)              |
| N° pozzetti                               | 96                        | N. of Well                      |

**RACCOMANDAZIONI D'USO/ RECOMMENDATIONS FOR USE** (a carattere esclusivamente informativo/ as informative) :


- Utilizzare esclusivamente per analisi di laboratorio/ *Use only for laboratory analysis,*
- In caso di fuoriuscita del contenuto usare i guanti pericolo di contaminazione / *Use gloves: contamination risk if contents leaks,*
- Non utilizzare il prodotto scaduto / *Do not use after expiry date or if packing is opened,*
- Non variare la destinazione d'uso/ *Do not vary the intended purpose of the product,*
- Prodotto non adatto ai bambini/ *Keep out of reach of children,*
- Conservare in luogo asciutto/ *Store in dry place and far from the direct light,*
- Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo la normativa vigente/ *Disposal: use appropriate, personal protective equipment and act according to applicable regulations.*

## REF BSD010

PIASTRA PER MICROMETODI 96 POZZETTI FONDO "U"  
IN CONFEZIONE SINGOLA IN SCATOLA DA 300PZ. STERILE

*MICROTITER PLATE 96 WELL "U" BOTTOM  
INDIVIDUALLY WRAPPED IN BOX OF 300 PCS. STERILE*

Codice CND: W0503010204 PIASTRE IN MATERIALE PLASTICO PER ANALISI CON MICROMETODICHE

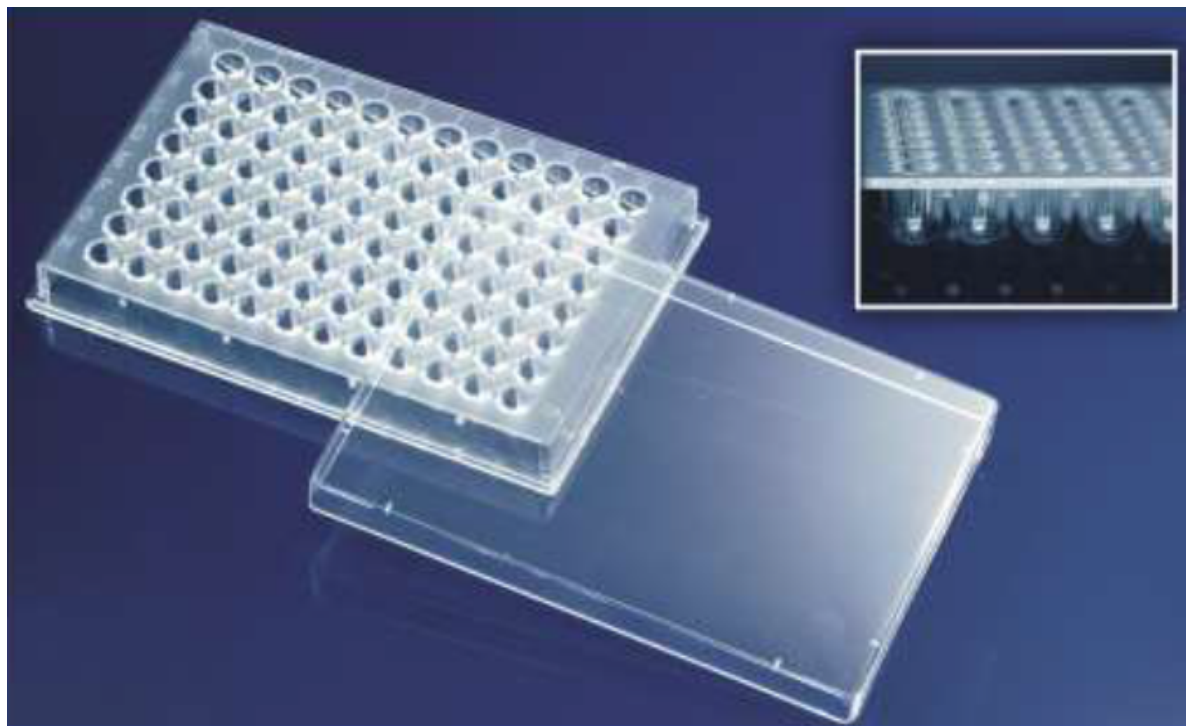

| CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DEL PRODOTTO |                           | FEATURES AND PRODUCT DIMENSIONS |
|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Fabbricante                               | Anicrin Srl, Italy        | Manufacturer                    |
| Codice Fabbricante                        | M09600U1                  | Manufacturer Code               |
| Stato microbiologico                      | STERILE / STERILE         | Microbiological status          |
| Materiale impiegato                       | POLISTIROLO / POLYSTYRENE | Material used                   |
| Lunghezza piastra (mm)                    | 127,70                    | Length plate (mm)               |
| Larghezza piastra (mm)                    | 85,80                     | Plate width (mm)                |
| Altezza piastra (mm)                      | 14,10                     | Plate height (mm)               |
| Peso (g)                                  | 40,00 ±1                  | Weight (g)                      |
| Capacità pozzetto(ml)                     | 0,281                     | Well capacity (ml)              |
| N° pozzetti                               | 96                        | N. of Well                      |


Dispositivo Medico Diagnostico In Vitro  
Destinato Esclusivamente Ad Uso Professionale  
*In Vitro Diagnostic Medical Device For Professional Use Only*

## REF BSD011

PIASTRA PER MICROMETODI 96 POZZETTI FONDO "V"  
IN CONFEZIONE SINGOLA IN SCATOLA DA 300PZ.

*MICROTITER PLATE 96 WELL "V" BOTTOM  
INDIVIDUALLY WRAPPED IN BOX OF 300 PCS.*

Codice CND: W0503010204 PIASTRE IN MATERIALE PLASTICO PER ANALISI CON MICROMETODICHE

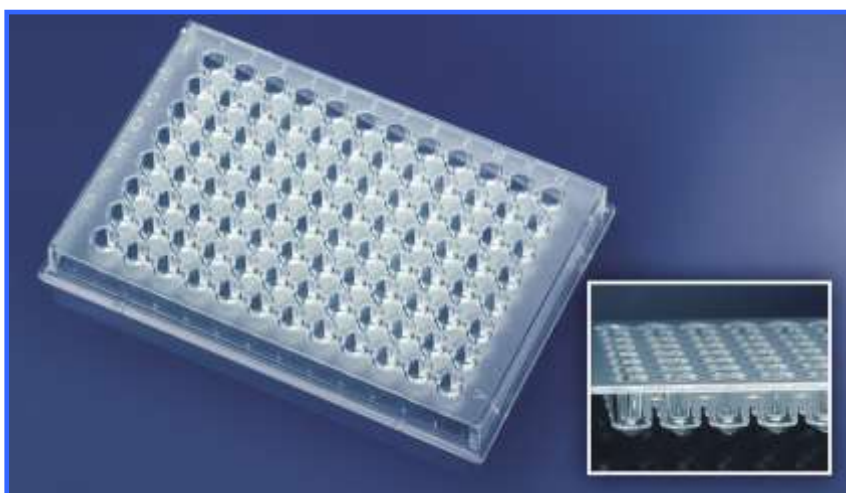

Dispositivo Medico Diagnostico In Vitro Destinato Esclusivamente Ad Uso Professionale  
*In Vitro Diagnostic Medical Device For Professional Use Only*

| CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DEL PRODOTTO |                           | FEATURES AND PRODUCT DIMENSIONS |
|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Fabbricante                               | ANICRIN SRL - ITALY       | Manufacturer                    |
| Codice Fabbricante                        | M09600V1                  | Manufacturer Code               |
| Stato microbiologico                      | STERILE / STERILE         | Microbiological status          |
| Materiale impiegato                       | POLISTIROLO / POLYSTYRENE | Material used                   |
| Lunghezza piastra (mm)                    | 127,70                    | Length plate (mm)               |
| Larghezza piastra (mm)                    | 85,80                     | Plate width (mm)                |
| Altezza piastra (mm)                      | 14,10                     | Plate height (mm)               |
| Peso (g)                                  | 40,00 ±1                  | Weight (g)                      |
| Capacità pozzetto(ml)                     | 0,219                     | Well capacity (ml)              |
| N° pozzetti                               | 96                        | N. of Well                      |

**RACCOMANDAZIONI D'USO/ RECOMMENDATIONS FOR USE** (a carattere esclusivamente informativo/ as informative) :


- Utilizzare esclusivamente per analisi di laboratorio/ *Use only for laboratory analysis,*
- In caso di fuoriuscita del contenuto usare i guanti pericolo di contaminazione / *Use gloves: contamination risk if contents leaks,*
- Non utilizzare il prodotto scaduto / *Do not use after expiry date or if packing is opened,*

## REF BSD012

PIASTRA PER MICROMETODI 96 POZZETTI FONDO PIATTO  
IN CONFEZIONE SINGOLA IN SCATOLA DA 300PZ. STERILE

*MICROTITER PLATE 96 WELLS FLAT BOTTOM  
INDIVIDUALLY WRAPPED IN BOX OF 300 PCS. STERILE*

Codice CND: W0503010204 PIASTRE IN MATERIALE PLASTICO PER ANALISI CON MICROMETODICHE

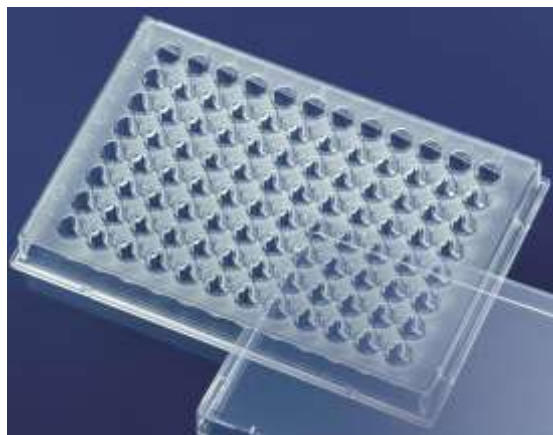

Dispositivo Medico Diagnostico In Vitro Destinato Esclusivamente Ad Uso Professionale  
*In Vitro Diagnostic Medical Device For Professional Use Only*

| CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DEL PRODOTTO |                           | FEATURES AND PRODUCT DIMENSIONS |
|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Fabbricante                               | ANICRIN SRL - ITALY       | Manufacturer                    |
| Codice Fabbricante                        | M09600P1                  | Manufacturer Code               |
| Stato microbiologico                      | STERILE / STERILE         | Microbiological status          |
| Materiale impiegato                       | POLISTIROLO / POLYSTYRENE | Material used                   |
| Lunghezza piastra (mm)                    | 128,00                    | Length plate (mm)               |
| Larghezza piastra (mm)                    | 85,80                     | Plate width (mm)                |
| Altezza piastra (mm)                      | 14,10                     | Plate height (mm)               |
| Peso (g)                                  | 40,00 ±1                  | Weight (g)                      |
| Capacità pozzetto(ml)                     | 0,404                     | Well capacity (ml)              |
| N° pozzetti                               | 96                        | N. of Well                      |

**RACCOMANDAZIONI D'USO/ RECOMMENDATIONS FOR USE** (a carattere esclusivamente informativo/ as informative) :

- Utilizzare esclusivamente per analisi di laboratorio/ *Use only for laboratory analysis,*
- In caso di fuoriuscita del contenuto usare i guanti pericolo di contaminazione / *Use gloves: contamination risk if contents leaks,*
- Non utilizzare il prodotto scaduto / *Do not use after expiry date or if packing is opened,*
- Non variare la destinazione d'uso/ *Do not vary the intended purpose of the product,*
- Prodotto non adatto ai bambini/ *Keep out of reach of children,*

## Plates adhesive film

106524



Adhesive film in polyethylene for PCR plate x100

**Sale Unit:** 100

106570



Axygen® PCR 35 µm Aluminum Sealing Film For General Sealing Purposes, Non sterile

**Sale Unit:** 100

BSD014



Transparent adhesive film for microplat 120x80 mm.

**Sale Unit:** 100

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: [bai@nt-rt.ru](mailto:bai@nt-rt.ru) || сайт: <https://biosigma.nt-rt.ru>